


— ALPHA
 — BÊTA
 — IODE
 — LIMITE DE DÉTECTION alpha, bêta, iode
 • ÉVÉNEMENTS
 - - - - - RADON

Activité volumique des canaux ALPHA, BÊTA et IODE (Bq/m³)

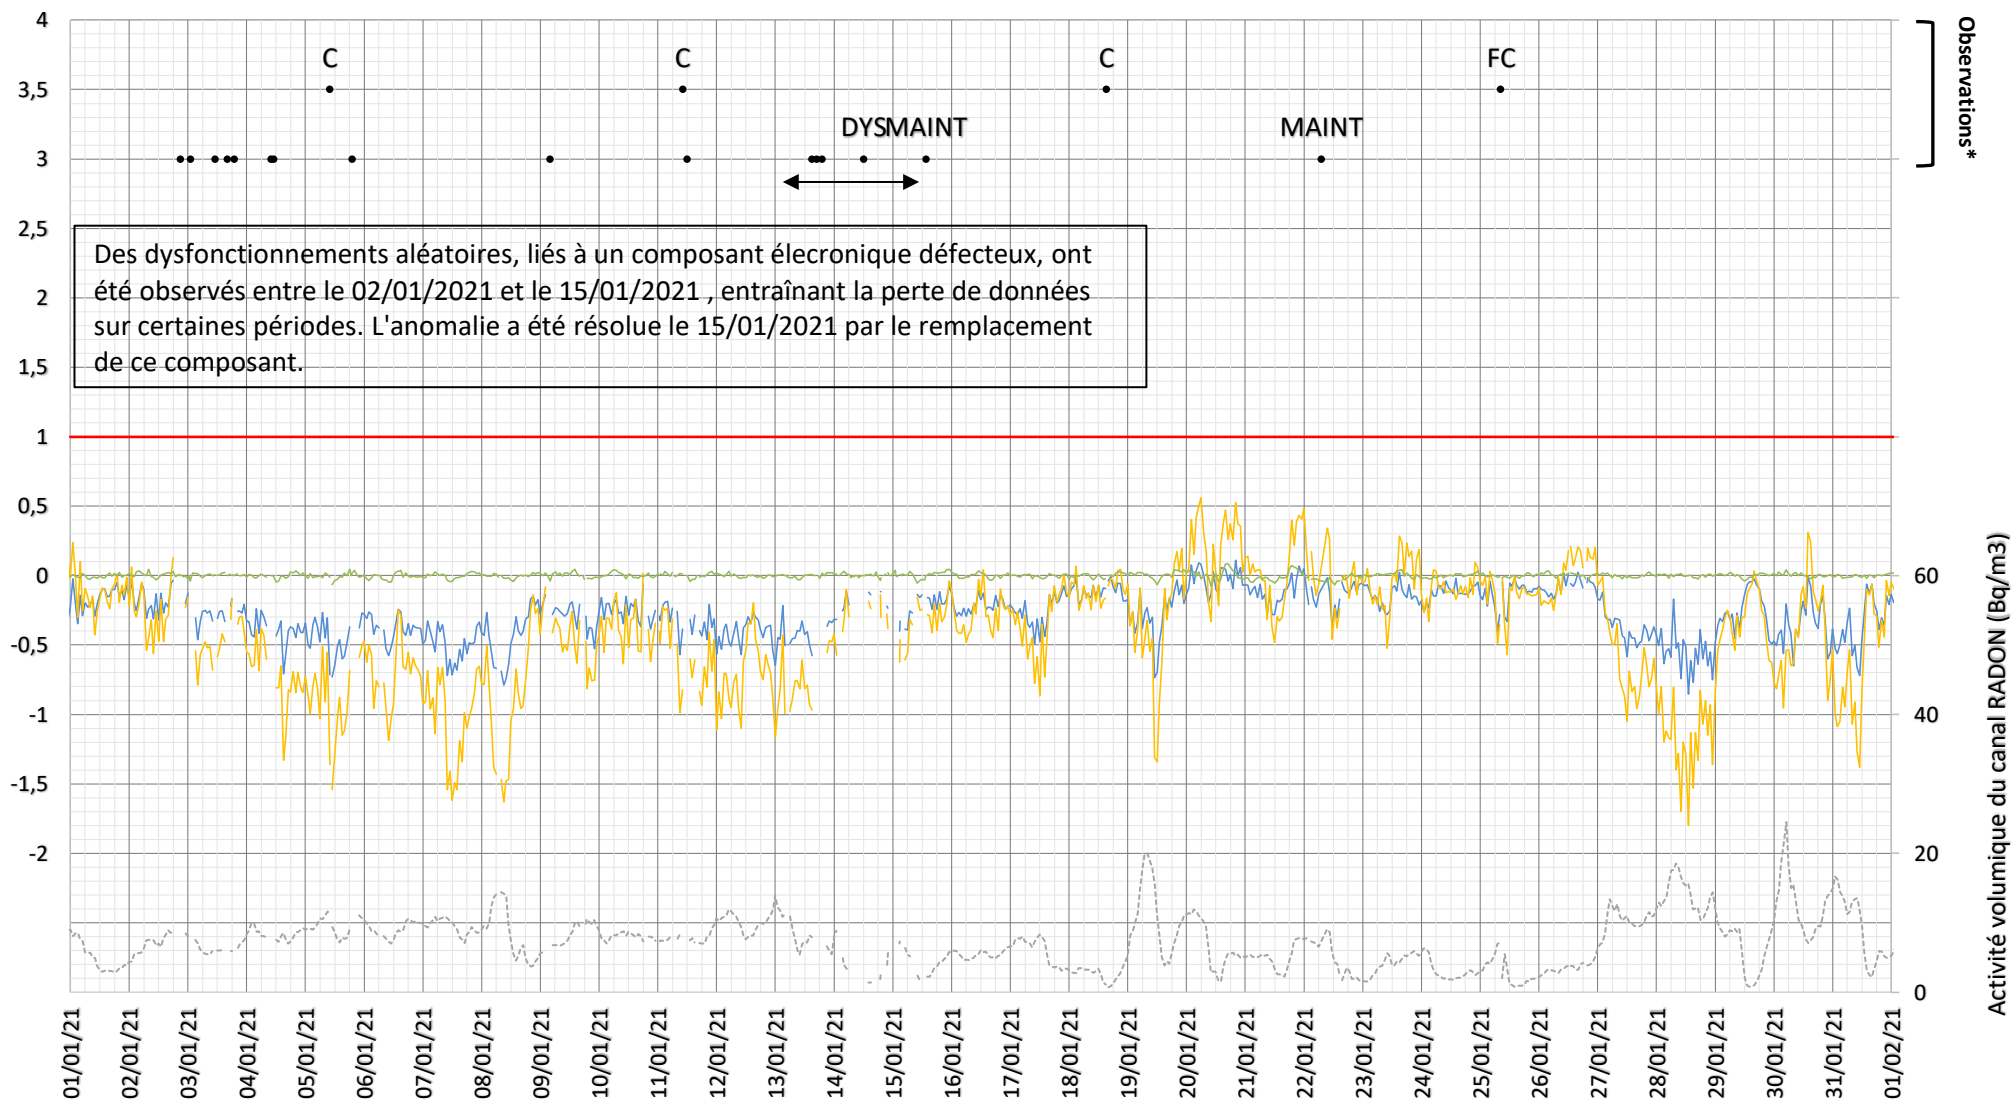

Des dysfonctionnements aléatoires, liés à un composant électronique défectueux, ont été observés entre le 02/01/2021 et le 15/01/2021, entraînant la perte de données sur certaines périodes. L'anomalie a été résolue le 15/01/2021 par le remplacement de ce composant.

Observations

Activité volumique du canal RADON (Bq/m³)

* : F/C = prélèvement de Filtre/Cartouche - Autres codes : cf. <http://balises.criirad.org/aide.htm>